

M/S

90.034
IE

KINVENT SENSORS

Manuale d'uso



KINVENT

Manuale d'uso dei sensori K-Sensors

K-Grip



K-Bubble



K-Push



K-Pull



K-Plates



K-Deltas



K-Move



K-Deltas XL



AVVISO

Il presente manuale d'uso presenta i prodotti K-SENSORS. Il contenuto informativo appartiene a KINVENT ed è fornito solo allo scopo di rendere operativi i dispositivi e i software K-SENSORS. Il presente manuale può subire modifiche. L'ultima versione è disponibile su <https://quickstart.k-invent.com/>

AVVISO

I consigli forniti in questo manuale intendono integrare, non sostituire, i normali requisiti di sicurezza prevalenti nel paese dell'utente


Produttore

KINVENT Biomécanique SAS
 Cap omega, Rond-Point Benjamin Franklin,
 34000 Montpellier, FRANCE
 +33 4 67 13 00 33
info@k-invent.com,
www.k-invent.com

© Copyright 2023 **KINVENT Biomécanique SAS**.

KINVENT Biomécanique, K-SENSORS, i relativi loghi e altri marchi commerciali e nomi commerciali KINVENT sono marchi registrati di KINVENT Biomécanique SAS. Tutti i diritti riservati. Il presente materiale non può essere riprodotto in Nessun modo, né fisico, né elettronico, senza il previo consenso scritto di KINVENT Biomécanique

Marchi

I marchi e le etichette utilizzati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi proprietari

Questo prodotto è protetto da brevetti concessi, domande di brevetto in corso e dai corrispondenti diritti nazionali.

Revisione:14

Ultima revisione: 2023-07-27, Stampato in Francia



Nome del dispositivo medico	Nome depositato
KForce Grip	K Grip
KForce Muscle Controller	K Push
KForce Plates	K Force Plates
KForce Bubble	K Bubble
KForce Sens	K Move
KForce Link	K Pull
KForce Deltas	K Deltas
KForce Deltas XL	K Deltas XL

Simboli grafici

	I dispositivi. Sono. Conformi alla normativa sulle apparecchiature elettromagnetiche della Federal Communications Commission.		Il dispositivo non funziona quando connesso ad una presa AC
	Conformità. europea MDR 2017/ 745		Apparecchiatura elettrica di Classe II
	IEC 60878 Corrente continua IN		Simbolo ISO 15223 Indica i limiti di temperatura ai quali il dispositivo può essere sottoposto durante uso, trasporto e deposito.
	Materiali di imballaggio riciclabili		Limitazione dell'umidità. Indica l'intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
	Conservare in luogo asciutto		Limitazione della pressione atmosferica. Indica l'intervallo di pressione atmosferica a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
	Il dispositivo è fornito non sterilizzato		Radiazione elettromagnetica non ionizzante
	Farre riferimento al manuale o. libretto d'istruzioni		L'apparecchiatura necessita di uno smaltimento adeguato. Smaltire secondo le normative locali
	Parte applicata tipo BF - Solo parti esterne Flottante - Nessun collegamento a terra		Avvertenza generale
	Numero di serie		Attenzione generale
	Produttore		Marchio Bluetooth. utilizza una radio Bluetooth LE per le comunicazioni wireless

Sommario

Table des matières

Manuale d'uso dei sensori K-Sensors	2	Dati sull'usabilità	22
Simboli grafici	4	Caratteristiche tecniche	23
Sommario	5	Dimensioni e Peso	23
Introduzione	7	Contenuto del pacchetto commerciale	23
Chi siamo	8	Accessori	24
Informazioni di sicurezza	8	Avvio	24
Avvertenze sui disturbi da fotosensibilità	8	K-Plates	26
K-Physio app 1.19	9	Descrizione	26
Installazione dell'applicazione sul dispositivo host	10	Vantaggi	26
Primo accesso (Login)	10	Dati sull'usabilità	26
Uso previsto	12	Caratteristiche tecniche	27
CONTROINDICAZIONI	12	Dimensioni e Peso	27
Avvertenze e precauzioni	13	Contenuto del pacchetto commerciale	27
Parti di ricambio	15	Installazione	28
Condizioni di funzionamento generali	16	Su pavimento	28
Ambienti	16	Su superficie verticale	28
Deposito, imballaggio, trasporto	16	Accessori	28
Calibrazione	16	Avvio	28
Cleaning	17	K-Bubble	30
Interfaccia	17	Vantaggi	30
LED	18	Dati sull'usabilità	30
K-Grip	19	Caratteristiche tecniche	31
Descrizione	19	Dimensioni e Peso	31
Vantaggi	19	Contenuto del pacchetto commerciale	31
Dati sull'usabilità	19	Accessori	32
Caratteristiche tecniche	20	Avvio	32
Dimensioni e Peso	20	K-Move	33
Contenuto del pacchetto commerciale	21	Qualifica utente	33
Accessori	21	Descrizione	33
Avvio	21	Vantaggi	33
K-Push	22	Dati sull'usabilità	33
Descrizione	22	Contenuto del pacchetto commerciale	33
Vantaggi	22	Caratteristiche tecniche	34
		Dimensioni e Peso	34
		Accessori :	35
		Avvio	35
		K-Pull	36
		Qualifica utente	36
		Descrizione	36

Dati sull'usabilità	36	USA)	59
Caratteristiche tecniche	37	Canada	59
Dimensioni e Peso	37	Japan	59
Contenuto del pacchetto commerciale	38	Svizzera :	60
Accessori :	38	Regno Unito:	60
Avvio	38	Contatti	61
K-Deltas	39		
Descrizione	40		
Vantaggi	40		
Dati sull'usabilità	40		
Caratteristiche tecniche	41		
Dimensioni e Peso	41		
Contenuto del pacchetto commerciale	42		
Accessori	42		
Installazione	42		
Su pavimento	42		
Avvio	43		
K-Deltas XL	44		
Qualifica utente	44		
Descrizione	44		
Vantaggi	44		
Dati sull'usabilità	44		
Caratteristiche tecniche	45		
Dimensioni e Peso	45		
Contenuto del pacchetto commerciale	45		
Installazione	46		
Su pavimento	46		
Avvio	46		
Risoluzione di problemi	47		
Problemi con il sensore	47		
Difficoltà di connessione	48		
Informazioni legali	50		
Condizioni di garanzia	50		
Unione europea	50		
Altri Paesi	50		
Assistenza	51		
Politica sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).	52		
Dichiarazione di conformità	53		
Informazioni FCC (Commissione Federale per le Comunicazioni degli			

Introduzione

Grazie per aver acquistato un prodotto K-Sensors.

K-SENSORS è la linea di prodotti sviluppata da KINVENT per misurare in modo preciso la riabilitazione ed è lo strumento completo che permette di valutare, monitorare e programmare esercizi per l'equilibrio, la forza e i movimenti articolari. Composta da 7 sensori, ognuno provvisto di sistemi di misura ad alta precisione, la linea K-SENSORS gode dell'eccellenza di KINVENT nello sviluppo dell'interfaccia, nella meccanica e nell'elettronica. **K-Sensors è composto da:**

K-Grip



per la misurazione della forza della mano

K-Bubble



per la riabilitazione con biofeedback attraverso strumenti pneumatici

K-Push



il dinamometro muscolare palmare

K-Pull



per la misurazione della forza senza la presenza dell'operatore

K-Plates



per la misurazione della forza degli arti inferiori e dell'equilibrio

K-Deltas



per l'analisi dei salti veloci e la misurazione della forza e dell'equilibrio degli arti inferiori

K-Move



Il goniometro elettronico wireless per la misurazione del range of motion



K-Deltas XL



per l'analisi dei salti veloci e la misurazione della forza e dell'equilibrio degli arti inferiori

Chi siamo

KINVENT è lo specialista della progettazione e della produzione di attrezzature biomeccaniche. Forti della nostra esperienza, concepiamo e realizziamo soluzioni per ogni esigenza nell'ambito degli sport biomeccanici e della riabilitazione fisica. I nostri prodotti comprendono pedane pronte all'uso, sensori inerziali wireless e diverse app personalizzate.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, consultare il sito www.k-invent.com.

Informazioni di sicurezza

Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza contenute nel presente manuale dell'utente devono essere seguite per garantire un funzionamento sicuro dei K SENSORS. Si noti che se l'apparecchiatura viene utilizzata in un modo non specificato da KINVENT, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe essere compromessa.

I seguenti tipi di informazioni sulla sicurezza compaiono in tutto il Manuale. I dettagli sono forniti nel formato mostrato di seguito:



Il termine AVVERTENZA viene utilizzato per informare l'utente su situazioni che potrebbero causare gravi danni al dispositivo o ad altre parti del Sistema e all'ambiente.



Il termine ATTENZIONE viene utilizzato per informare su situazioni che potrebbero causare danni al dispositivo che influenzano i risultati della misurazione o rappresentano un rischio per la sicurezza del paziente/utente o dell'operatore.



Il termine AVVISO viene utilizzato per indicare informazioni considerate importanti ma non correlate a pericoli (ad esempio, messaggi di sicurezza, linee guida per la manutenzione e la pulizia)

Avvertenze sui disturbi da fotosensibilità



È opportuno tenere presente che alcune persone possono essere soggette ad attacchi epilettici, dovuti alla fotosensibilità durante l'esposizione a immagini che emettono luci lampeggianti o a disegni che potrebbero apparire nei videogiochi. Anche le persone che non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità o epilessia potrebbero presentare una patologia non diagnosticata in grado di causare « attacchi epilettici da fotosensibilità » durante l'utilizzo di videogiochi. Tali disturbi possono manifestarsi con vari sintomi, quali visione alterata, contrazioni oculari o facciali, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, disorientamento, stato confusionale o temporanea perdita della coscienza. Le convulsioni o la perdita di coscienza possono provocare lesioni dovute a cadute o impatti con oggetti circostanti..

In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l'utilizzo del videogioco e consultare un medico. I genitori dovrebbero fare attenzione ai propri figli o chiedere loro in merito ai sintomi sopra descritti.

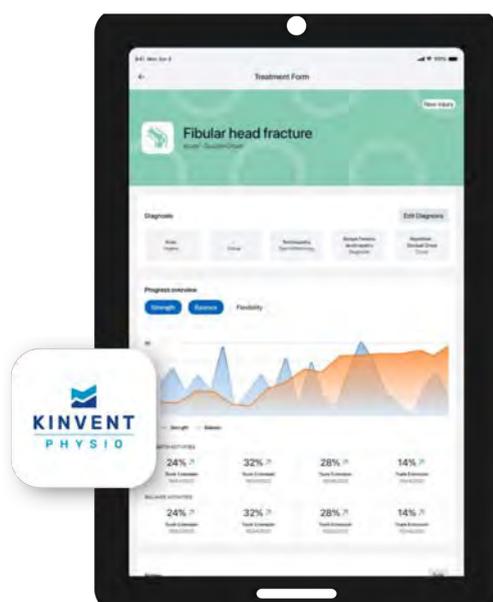
K-Physio app 1.19¹

Kinvent Physio è l'unica app necessaria per l'uso di tutti i sensori Kinvent. Sono disponibili tutorial del suo funzionamento online : [Quickstart.k-invent.com](https://www.kinvent.com/quickstart).

Per accedere ai tutorial direttamente dallo smartphone, inquadrare il codice QR qui a lato con la fotocamera.

Requisiti minimi: Android 6.0+ o iOS 11.0+, 2 GB di RAM Bluetooth Low Energy, Schermo 5"

Consigliato: Android 8.0+ o iOS 16.0+, 4 GB di RAM, Bluetooth Low Energy 5.0+, diagonale dello schermo da 6,5" (16,5 cm)



¹ L'ultima versione potrebbe differire nello store

Installazione dell'applicazione sul dispositivo host

Scarica l'app da Google Play per dispositivi Android o dall'App Store per dispositivi iOS

Segui le Istruzioni per la registrazione sull'App

Collega il dispositivo con l'app tramite BLE



Primo accesso (Login)

L'app K Physio richiederà una registrazione iniziale e alcune informazioni riguardanti la specialità e il profilo dell'operatore per garantire un uso corretto.

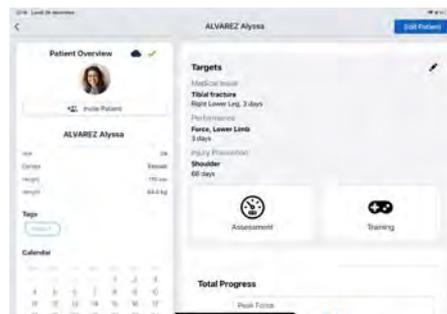
È necessario collegare i K SENSORS con dispositivi Bluetooth® Low Energy (BLE) compatibili per archiviare, analizzare e visualizzare i dati di misurazione. Questi dispositivi host possono essere, ad esempio, dispositivi mobili che eseguono rispettive applicazioni host (K Physio) per la visualizzazione dei dati.

I sensori possono essere registrati nell'app K Physio per essere facilmente identificati all'inizio di un esercizio.

È possibile registrare i dispositivi con più dispositivi host, ma può essere attiva solo una connessione alla volta.

Cartella completa del paziente

Compila le informazioni sulla patologia del paziente per guidare la cura e rendere disponibile la sua cartella a tutti gli operatori sanitari del tuo studio.



Report personalizzati

Sintetizza i risultati della tua riabilitazione con il modulo di esportazione multipla.

Valutazioni premium

Adotta un approccio scientifico ai protocolli standard convalidati: CMJ, Drop jump, Squat jump, McCall test, ASH test, squat analysis, Romberg, test profile strength, DSI, EVA, max strength, IMPT, antagonist ratio, posture analysis.



K-apture

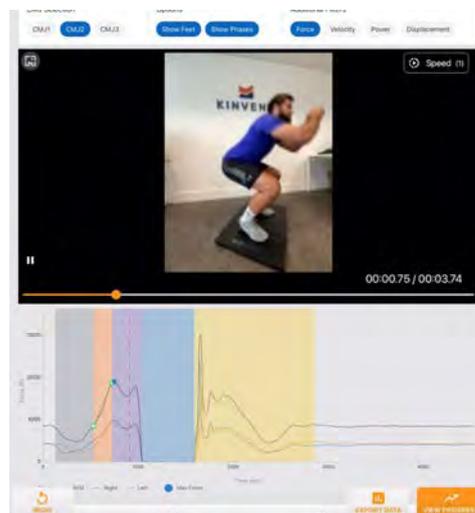
Filma il movimento del tuo paziente e sincronizzalo con ogni valutazione Kinvent Physio. Effettua analisi qualitative da integrare nei tuoi report.

MyKinvent

Offri al tuo paziente l'agenzia nella loro riabilitazione dando loro accesso ai propri dati.

Kinvent Connect

Centralizza tutti i tuoi dati in un unico posto e accedi da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer, ecc.



Uso previsto

Uso previsto

I K-Sensors sono destinati a essere utilizzati da professionisti qualificati per assistere nella valutazione obiettiva della forza fisica, dell'equilibrio e dell'ampiezza di movimento di una persona.

I K Sensors possono essere utilizzati da professionisti medici presso strutture sanitarie o a domicilio dei pazienti. I K Sensors di KINVENT devono essere utilizzati da personale che abbia familiarità con i K Sensors e abbia la formazione adeguata

I K SENSORI sono

- Apparecchiature elettromedicali
- Apparecchiature alimentate internamente (a batteria)
- Con parte applicata di tipo BF
- Operazione continua
- Non adatto per il funzionamento in un ambiente ricco di ossigeno

La durata prevista in condizioni di utilizzo normale è di 5 anni

ATTENZIONE

Sostituire il dispositivo al termine della vita utile prevista o prima se si verifica una delle seguenti condizioni:

- diversamente istruito o
- le condizioni di esercizio più gravose del normale abbiano causato il deterioramento delle caratteristiche essenziali o
- se si osservano danni al dispositivo (ad es. crepe o danni strutturali).
- Vedere il paragrafo per la guida al riciclaggio.

CONTROINDICAZIONI

I sensori K-Sensors sono controindicati nei seguenti casi:

- Posizionati su o vicino a ferite aperte
 - Pazienti con gravi forme di osteoporosi
 - Posizionati su o vicino a tessuti ustionati
 - Posizionati su o vicino agli occhi
 - Posizionati su o vicino a fratture
 - Qualsiasi uso non espressamente indicato
-

Avvertenze e precauzioni

Le informazioni sulla sicurezza devono essere lette attentamente e comprese prima di iniziare a lavorare con K-SENSORS

AVVERTENZA

- Prenditi cura del forte attaccamento o presa di ciascun sensore.
- Non mettere i sensori K-Sensors nel fuoco.
- I sensori K-Sensors contengono batterie a ioni di litio. *Non gettare* le batterie nei rifiuti domestici.
- I sensori e gli accessori K-Sensors vengono forniti non sterili e non sono compatibili con tecniche di sterilizzazione, ivi compresa l'autoclave.
- Non sterilizzare in autoclave.
- Utilizzare unicamente alimentatori a parete o caricabatterie fornite dal produttore. L'utilizzo di caricatori non raccomandati dal produttore può causare scosse elettriche o danni ai dispositivi.
- I dispositivi K-Sensors non possono essere usati durante il loro collegamento a prese o a caricabatterie.
- Non tentare mai di utilizzare i dispositivi mentre sono collegati a caricabatterie: pericolo di scosse o danni ai dispositivi.
- I dispositivi K-Sensors non sono protetti contro le infiltrazioni di liquidi. Mantenere in luogo asciutto. Non immergere i dispositivi e gli accessori K-Sensors in acqua.

ATTENZIONE

- Utilizzare il dispositivo solo nell'ambiente esistente durante le attività quotidiane di routine. Non utilizzare il dispositivo durante attività intense o irregolari o al di fuori del proprio ambiente naturale, a meno che non sia stato espressamente indicato diversamente dal proprio medico o fisioterapista.
- Non guidare o utilizzare macchinari pesanti mentre si indossa il dispositivo.
- Gli utenti con disabilità (es. disturbi neurologici, osteoporosi), che possono causare controindicazioni, o gli utenti per i quali l'esercizio fisico può essere estremamente pericoloso, devono prendere precauzioni per garantire la loro sicurezza durante l'utilizzo del dispositivo (es. supervisione, ecc.).
- Non utilizzare il dispositivo se si sospetta che sia difettoso o danneggiato. Non cercare di riparare il dispositivo da solo.
- Segnala qualsiasi cambiamento nelle tue condizioni mediche correlato alla diagnosi o al trattamento al tuo medico o fisioterapista.
- Non dare, vendere, affittare o consentire l'uso del tuo dispositivo a o da parte di un'altra persona.
- Interrompere immediatamente l'uso del sistema se le parti sono danneggiate o se si osserva un cambiamento nelle prestazioni.
- Interrompere immediatamente l'uso del sistema se si osserva una reazione allergica.
- Non modificare questo sistema senza previa autorizzazione scritta del produttore. Se questo sistema viene modificato, è necessario eseguire ispezioni e test appropriati per garantire un uso continuo e sicuro del sistema.
- Consultare sempre il proprio medico se si dispone di una condizione medica e prima di iniziare un programma.
- Consultare sempre il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo se si dispone di un pacemaker o di un altro dispositivo impiantato. Sebbene diversi produttori di pacemaker impiantati affermino che il rischio associato all'uso simultaneo è basso,

è essenziale consultare un medico che conosca l'esatto tipo e modello del dispositivo impiantato in questione prima di utilizzare il sistema. In ogni caso tenere il dispositivo ad almeno 15cm (6") di distanza dal dispositivo impiantato.

- Non utilizzare il dispositivo durante la risonanza magnetica (MRI), a meno che non sia stato specificamente approvato dal personale che utilizza l'apparecchiatura MRI. La batteria all'interno del dispositivo è sensibile ai campi magnetici.
- Il dispositivo non è per più utenti se le conseguenze di una possibile contaminazione incrociata possono essere gravi. Si raccomanda un'attenta pulizia e disinfezione per prevenire infezioni incrociate se utilizzato da più utenti.
- Le parti conduttive del dispositivo non devono entrare in contatto con parti conduttive, incluso il collegamento di messa a terra di protezione.
- Tenere il dispositivo e qualsiasi parte del sistema lontano dalla portata di bambini, animali domestici o parassiti quando non in uso.
- Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del sistema. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questo sistema.
- L'uso di questo sistema accanto o impilato con altre apparecchiature dovrebbe essere evitato perché potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questo sistema e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificare che funzionino normalmente.
- Se la temperatura di conservazione è inferiore a 0°C, lasciare stabilizzare la temperatura interna delle parti del sistema per almeno 30 minuti prima dell'uso. Fai attenzione alla condensa
- Se la parte del sistema deve essere utilizzata in un ambiente soggetto all'accumulo di sporcizia, pulire regolarmente il dispositivo. Per la pulizia seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "Pulizia".
- Utilizzare il sistema ad almeno 30 cm (12") di distanza da sorgenti di campi magnetici a frequenza di linea elettrica, apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza e altre sorgenti di segnali a radiofrequenza (come radar o forni a microonde).
- Se i risultati della misurazione sono fluttuati da una forte fonte di disturbo in radiofrequenza nelle vicinanze, allontanarsi ulteriormente dalla fonte dei disturbi in radiofrequenza.
- Evitare di utilizzare il sistema in prossimità di fonti di disturbo elettrostatico. Non utilizzare vicino a una sorgente di segnale a 2,4 GHz, poiché segnali forti potrebbero influire negativamente sulle prestazioni del collegamento radio.
- Prima di ogni utilizzo del dispositivo si consiglia di controllare e confermare che le parti siano fissate correttamente.
- In caso di problemi dovuti al dispositivo, si consiglia di interrompere immediatamente l'uso e di contattare immediatamente il medico o il medico
- Contattare il produttore nel caso sia necessaria assistenza per la configurazione, l'utilizzo o la manutenzione del dispositivo o per segnalare operazioni o eventi imprevisti.
- I sensori K-Sensors devono essere usati solo da professionisti qualificati.
- I dispositivi K-Sensors sono strumenti medici di precisione, da trattare con cura. Non far cadere o provocare qualsiasi impatto ai dispositivi; durante il loro uso assicurarsi di avere una buona presa, al fine di evitarne la caduta accidentale e il conseguente danneggiamento o eventuali danni al paziente o all'operatore.
- Si sconsiglia l'uso in condizioni di temperature estreme, di elevata umidità o di luce solare diretta.
- Assicurarsi che il paziente sia in grado di mantenere l'equilibrio mentre guarda lo schermo al fine di evitare cadute.

- I sensori non contengono materiali pericolosi, tuttavia, per un'eliminazione adeguata, è necessario rivolgersi alle strutture locali di smaltimento rifiuti. Si raccomanda di ricorrere al riciclaggio ogni qualvolta sia possibile.
- Non eseguire la manutenzione della batteria mentre il dispositivo è in uso.
- Non smontare o modificare il sistema con l'uso di accessori non espressamente approvati da KINVENT Biomécanique, LLC. Non solo tali interventi annullano la garanzia dei dispositivi, ma vi è anche il rischio di provocare la riduzione della schermatura da interferenze elettromagnetiche, nonché di aumentare le emissioni elettromagnetiche e di causare un funzionamento non corretto.
- Non disporre i dispositivi K-Sensors su superficie instabili o soggette a vibrazioni.
- Le apparecchiature elettromedicali necessitano di precauzioni specifiche relative alle emissioni ECM. I dispositivi K-Sensors devono essere installati e messi in funzione secondo le indicazioni fornite nel presente manuale.

Parti di ricambio

- Cinghie
- Fasce
- Maniglie
- Cuscinetti
- Accessori di fissaggio in gomma

Condizioni di funzionamento generali

Ambienti


I dispositivi K-Sensors devono essere utilizzati al chiuso, in locali puliti, asciutti e con pavimento livellato. Durante l'utilizzo del dispositivo, assicurarsi di avere uno spazio circostante adeguatamente ampio.

Deposito, imballaggio, trasporto


Temperatura:
da -10 °C a 40 °C



Pressione dell'aria:
da 70 kPa a 106 kPa



Umidità dell'aria:
dal 30% al 75%



Quando i dispositivi non sono usati, disporli nelle custodie di protezione da trasporto.

Se i dispositivi K Sensors non vengono utilizzati per più di 30 giorni consecutivi, verificare il livello della batteria ed eventualmente ricaricarla prima dell'uso.

ATTENZIONE

Osservare attentamente le condizioni di deposito e conservazione dei dispositivi. Non depositare in un veicolo, eccetto per la fase del trasporto.

Calibrazione

I dispositivi K-Sensors forniscono la misurazione della forza muscolare e sono venduti già calibrati, pronti per l'uso.

Si raccomanda di effettuare un controllo della calibrazione almeno una volta all'anno in caso di uso normale, più frequentemente in condizioni di uso sostenuto. L'utente non può intervenire sui dispositivi K-Sensors e non viene fornito alcun manuale di assistenza. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore K-Sensors.

Cleaning

AVVISO

Il paragrafo sulla pulizia deve essere letto attentamente e compreso prima di iniziare il lavoro di pulizia.

I K-sensori devono essere puliti dopo ogni utilizzo. La pulizia e la disinfezione dei sensori K può essere eseguita dall'operatore del sistema o dal paziente/utente.

Per pulire l'alloggiamento del K SENSOR, utilizzare un panno umido inumidito con acqua o un detergente delicato. Se lo sporco è persistente, strofinare la superficie del K SENSOR con un panno inumidito con disinfettante a base di etanolo o con solvente alcolico al 70%. Non utilizzare detergenti aggressivi come l'acetone.

Per le macchie più persistenti e per la disinfezione del K SENSOR è necessario **utilizzare disinfettanti di livello basso o intermedio (ad es. salviettine imbevute di alcol). Non utilizzare candeggina per pulire le parti in plastica, preferire miscele alcoliche**

Non utilizzare oggetti che potrebbero danneggiare o graffiare la superficie.

Se l'interno del K SENSOR è contaminato, contattare direttamente il distributore locale o l'assistenza KINVENT.

AVVERTENZA

Si raccomanda un'attenta pulizia e disinfezione da parte dell'operatore tra un utilizzo e l'altro per prevenire infezioni incrociate se indossato da più utenti o pazienti. Disinfettare prima e dopo ogni utilizzo. Lasciare asciugare i disinfettanti prima di utilizzarli. Non deve essere indossato da più utenti se le conseguenze della contaminazione incrociata possono essere gravi.

AVVISO

La disinfezione ripetuta con disinfettante a base di etanolo può a lungo andare causare l'invecchiamento e lo scolorimento della custodia utilizzata. Lo scolorimento non pregiudica l'uso sicuro. Se si osservano crepe o danni strutturali, sostituire il dispositivo.

Interfaccia

Tutti i dispositivi K-Sensors presentano la stessa interfaccia

- 1- LED multicolore
- 2- Porta USB-C di ricarica
- 3- Avvio / Tasto di avvio arancione



LED

- Quando viene collegato via USB, il sensore si accende (LED lampeggiante **VERDE**) e comincia il caricamento della batteria interna.
- Se non viene connesso all'app entro 10 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Una luce lampeggiante **ARANCIONE** indicherà che la batteria sta caricando.
- Il passaggio del colore del LED ad una luce fissa **BIANCA** indica il termine del caricamento della batteria. Se l'alimentazione viene interrotta, il dispositivo si riaccenderà nuovamente.
- Il sensore viene attivato collegando il cavo USB o premendo il tasto arancione. Il led **VERDE** inizia quindi a lampeggiare.
- L'avvenuta connessione via Bluetooth sarà indicata dal passaggio del colore del LED lampeggiante al **BLU**.
- In caso di batteria a bassa carica, la spia **ROSSA** lampeggerà a intermittenza per tre volte ogni 5 secondi. Se si opera in tali condizioni, la portata wireless può essere ridotta.
- Se la carica della batteria scende al di sotto dell'1%, il dispositivo si spegnerà.
- Premendo brevemente il pulsante, il dispositivo indicherà il livello di carica della batteria con una luce intensa di colore **rosso, giallo o verde**.

Visual	LED Functionality	Explanation	Action requested
	Il LED è SPENTO	Il sensore è SPENTO	Press the button to power on the sensor
	Il LED è VERDE e lampeggia	Il sensore è ACCESO	Normal operation - Sensor is ready to connect
	Il LED è BLU e lampeggia	Il sensore è Connesso	Sensor is connected to the app (tablet/phone)
	Il LED ARANCIONE lampeggia lentamente	In carica	None- the sensor will continue charge until full
	LED BIANCO fisso	Carica terminata	Internal battery is 100%, please remove charging cable
	Il LED ROSSO lampeggia 3 volte	La carica della batteria è bassa (<10%)	Please charge the sensor
Action	LED behavior	Explanation	
Tasto premuto una volta	Colore LED a luce fissa Verde, Giallo o Rosso	Indica per 5 secondi il livello della batteria Verde, carica >70% Giallo, carica >30% Rosso <30%	
tasto premuto una volta durante una "schermata di avvio" dell'app	Colore LED a luce fissa Verde, Giallo o Rosso	Inizierà anche l'allenamento/esercizio selezionato o cambierà lato a seconda del messaggio dell'app	



K-Grip

Descrizione

K-Grip è usato nella valutazione della forza della presa manuale. È possibile misurare la forza isometrica attraverso la forza massima o la forza media. Il dinamometro Grip permette di misurare quantitativamente la debolezza della presa della mano colpita da traumi, rispetto alla forza della mano sana.

Vantaggi

K-Grip è munito di trasduttori elettronici che forniscono un biofeedback in tempo reale su tablet o smartphone, tramite l'app Kinvent Physio. È possibile non solo fissare obiettivi di forza per il paziente, motivandolo nel processo di riabilitazione, ma anche seguire i suoi progressi attraverso il database interattivo Kinvent Physio.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Per la valutazione della forza della presa della mano

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Grip deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

K Grip è dotato di un trasduttore di forza elettronico che converte le forze applicate in segnali elettrici che vengono poi convertiti in uscite digitali calibrate.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	170 g / 6 oz
Dimensioni (H x L x P)	Metric : 146.5 x 36 x 60.5 mm US : 5.77 x 1.42 x 2.38 "
A- Punto di attacco del nastro. B- Tasto	
Forza massima	90 kg / 198 lbs
Precisione	< 0.2%, +-0.1kg / +-0.22lbs
Frequenza di acquisizione	1000 Hz
Maniglia variabile	Morbide copri impugnature rimovibili (magnetiche) in TPE.
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare KgF, N, lbs

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 280 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 40 metri / 44 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807
Batteria	12 ore in uso continuo, 2h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

- K-Grip
- Cavo di collegamento
- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica
- Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A
- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Accessori

Nella parte posteriore di K-Grip è posizionata una cordicella (amovibile) che permette di assicurare il sensore al braccio del paziente.

Per permettere una migliore utilizzazione secondo le diverse dimensioni di mano, K-Grip prevede in opzione impugnature amovibili di diverse taglie. Essendo magnetiche vengono applicate facilmente e rimosse altrettanto facilmente con un semplice gesto che abbia una forza di trazione pari a 1kg. Il dispositivo è fornito con un accessorio di protezione di dimensioni standard. Per altre taglie consultare il catalogo.

Avvio

Sulla parte superiore del sensore sono presenti: una porta USB-C usata per effettuare la ricarica, un LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e lo stato della ricarica e un tasto.

È possibile caricare il sensore K-Grip con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB-C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medico IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica e, in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.

AVVERTENZA Prima dell'uso, disinfettare K-Grip con salviette disinfettanti a basso o medio livello di disinfettante (p.es: salviette con alcool). Non usare candeggina sulle parti in plastica, preferire disinfettanti composti con alcool.

Premere il tasto arancione di avvio sul K-Grip. Non appena l'indicatore comincia a lampeggiare con una luce verde, il sensore è in funzione! Dopo 10 minuti di mancata connessione a Bluetooth o all'applicazione, il dispositivo si spegnerà.

Quando il sensore è acceso, selezionare l'attività del K-Grip nella Homepage. Il passaggio del LED alla luce lampeggiante Blu indicherà che K-Grip è connesso.

AVVISO Attenzione: quando Grip è connesso non esercitare nessuna pressione sul dispositivo, non spostarlo, non appoggiarvi i piedi, mantenerlo in posizione verticale su una superficie piana.

K-Push



Descrizione

K-Push è un dinamometro manuale utilizzato per la valutazione della forza di diversi muscoli. È possibile misurare la forza isometrica tramite i picchi di forza e la forza media, per un muscolo specifico o per un gruppo di muscoli.

K-Push permette di misurare quantitativamente sia la forza muscolare che la percentuale del deficit muscolare causato da traumi, rispetto alla forza del lato sano.

Vantaggi

K-Push è dotato di trasduttori di forza elettronici che forniscono un Biofeedback acustico e ottico in tempo reale su smartphone o tablet, tramite l'app Kinvent Physio. Grazie a esercizi pensati specificatamente, il dispositivo permette di programmare obiettivi per i pazienti tali da incoraggiarli a dare il massimo. L'app, inoltre, registra i risultati dei pazienti, permettendo così di seguire sul database i loro progressi in Forza Massima, Resistenza e Simmetria muscolare.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Per la valutazione della forza di diversi muscoli

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Push deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

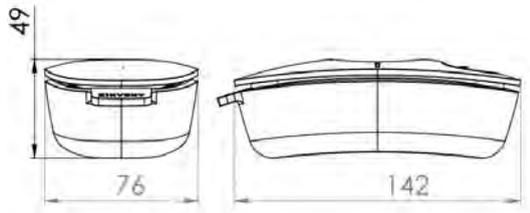
Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

K Push è dotato di un trasduttore di forza elettronico che converte le forze applicate in segnali elettrici che vengono poi convertiti in uscite digitali calibrate.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	370 grammi (incluso il cuscinetto)
Dimensioni (H x L x P)	Metric : 48 x 142 x 76 mm US : 5.77 x 1.42 x 2.38 "
A- Punto di attacco del nastro. B- Tasto	
Forza massima	90 kg / 198 lbs
Precisione	< 0.1%, +-0.1kg
Frequenza di acquisizione	1000 Hz
Dimensioni dell'impugnatura variabile	Cuscinetto di silicone con interno soffice
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare KgF, N, lbs

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 280 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 40 metri / 44 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807
Batteria	12 ore in uso continuo, 2h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

- K-Push
- Maniglia a due mani (Twin Handle)
- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica
- Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A
- Un supporto per le mani con cintura

- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Accessori

Il sensore permette di aggiungere accessori attraverso un sistema di ancoraggio magnetico posto sulla parte superiore del dispositivo.

Twin Handle è un accessorio dalla doppia impugnatura che permette un uso più agevole del K-Push in situazioni di forza elevata. È adatto a misurazioni che richiedono una presa a due mani stabile e controllata. L'uso di un dinamometro portatile non è mai stato così facile e confortevole.

Il set di valutazione Nordic permette un montaggio sicuro del K-Push su barre da ginnastica o su iso-box, in conformità al protocollo del test Nordic Hamstring.

Avvio

Il sensore è dotato di cuscinetto preinstallato, che può essere sistemato facilmente grazie al sistema di posizionamento a scatto.

Regolare la lunghezza delle cinghie in base alle dimensioni della mano, quindi posizionare quest'ultima sul cuscinetto. È possibile sostituire l'impugnatura con l'accessorio Nordic o con Twin Handle.

AVVERTENZA Il cuscinetto può essere rimosso per la pulizia. **Prima dell'uso, disinfettare il dispositivo** con salviette disinfettanti a base di alcool.



Per cambiare l'impugnatura, fare una rotazione in senso orario di 45 gradi (posizione diagonale). L'impugnatura si solleverà da sola e sarà possibile tirarla e rimuoverla facilmente.

Sulla parte superiore del sensore sono presenti: una porta USB-C usata per effettuare la ricarica, un LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e della ricarica e un tasto.

È possibile caricare il sensore K-Push con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB-C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medicale IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica; in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.

Premere il tasto arancione di avvio sul sensore K-Push. Non appena l'indicatore comincia a lampeggiare con una luce verde, il sensore è in funzione! Dopo 10 minuti di mancata connessione a Bluetooth o all'applicazione, il dispositivo si spegnerà.

Quando il sensore è acceso, selezionare l'attività del sensore K Push nella Homepage. Selezionare la parte del corpo da misurare e quindi l'esercizio da praticare. Il passaggio del LED al colore Blu indicherà che K-Push è connesso

AVVISO

Quando K-Push è connesso non esercitare nessuna pressione sul dispositivo, non spostarlo, non appoggiarvi i piedi.

AVVISO

Per una maggiore precisione della misurazione delle forza isometrica, la posizione del fissaggio dovrebbe essere sempre uguale e perpendicolare alla direzione della forza esercitata.

K-Plates



Descrizione

Le pedane K-Plates sono composte da due piattaforme indipendenti studiate per la riabilitazione dell'equilibrio, la valutazione della simmetria e della forza muscolare degli arti inferiori.

Vantaggi

Le pedane K-Plates sono munite di trasduttori elettronici di forza e forniscono in tempo reale biofeedback acustici e ottici su smartphone o tablet tramite l'app Kinvent Physio. Ogni pedana possiede 4 sensori indipendenti, posti su ogni angolo, che permettono di misurare il centro di pressione. Per stabilizzare correttamente il sensore su una superficie, le pedane sono provviste di piedini filettati regolabili.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Riabilitazione dell'equilibrio e valutazione della simmetria e forza muscolare degli arti inferiori.

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Force Plates deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

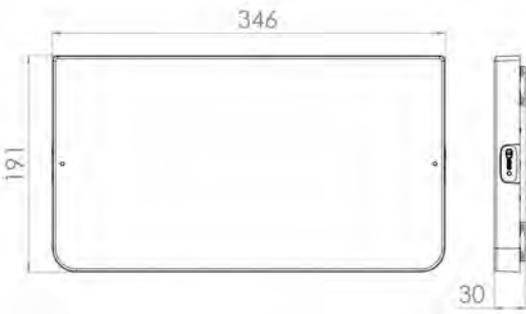
Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

I K Force Plates sono dotati di 4 trasduttori elettronici di forza per piattaforma che convertono le forze applicate in segnali elettrici che vengono poi convertiti in uscite digitali calibrate.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	2000 grammi / 4,4 libbre per piattaforma
Dimensioni (H x L x P)	Metrico 30 x 346 x 191 mm US: 1,18x13,62x7,52"
Altezza libera dal suolo di 5 mm/0,2".	
Forza massima	600 kg / 1322 libbre per piattaforma
Precisione	< 0.1%, +-0.1kg / +-0.22lbs
Frequenza di acquisizione	1000 Hz Full CoP
Rivestimento	Foglio antiscivolo R11
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare KgF, N, lbs

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 800 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 20 metri / 22 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807 o X8WBM833
Batteria	20 ore in uso continuo, 2h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

- K-Force Plates (2x plateformes)
- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica

- 2x Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A
- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Installazione

Installare K-PLATES secondo la misurazione programmata .

Su pavimento

Ideale per gli esercizi di equilibrio. È possibile disporre le due piattaforme sul pavimento una a contatto dell'altra o distanziate. In tal modo, si può far lavorare la forza muscolare di entrambi gli arti inferiori, aumentando il livello di difficoltà degli esercizi.



Su superficie verticale

Le pedane K-PLATES possono essere fissate a parete per misurare la forza muscolare degli arti superiori, o anche su macchinari per il sollevamento pesi, come le presse per palestra. A tal fine, utilizzare bastoncini in Velcro con una superficie di almeno 200 cm².

AVVERTENZA Prima dell'uso, è necessario assicurarsi che le pedane K-PLATES siano saldamente fissate alle superfici verticali utilizzate come supporto.

Accessori

Jump Frame, accessorio studiato per le K-Plates, permette di stabilizzare le pedane e di ottenere una maggiore superficie alla stessa altezza, consentendo di effettuare salti in tutta sicurezza. Permettendo anche di regolare la distanza tra le pedane, facilita l'adattamento al confort del paziente. Inoltre, garantisce la riproducibilità delle misurazioni in condizioni analoghe. Jump Frame è realizzato in schiuma rigida. La sua leggerezza e facilità di trasporto garantiscono la sicurezza dei pazienti.

Avvio

Sulla parte laterale del sensore sono presenti: una porta USB-C usata per effettuare la ricarica, un LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e della ricarica e un tasto. Sulla parte superiore è posizionato un secondo LED, che funziona contemporaneamente a quello laterale.

È possibile caricare il sensore K-Plates con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB-C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medicale IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica e, in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.

AVVERTENZA

Prima dell'uso, disinfettare K-PLATES con salviette disinfettanti a base di alcool.

Premere il pulsante d'avvio arancione che si trova sulle K-Plates. Non appena una luce verde comincia a lampeggiare, il sensore è in funzione! Dopo 10 minuti di mancata connessione a Bluetooth o all'app, il dispositivo si spegnerà. Riaccendere entrambe le pedane.

Quando il sensore è acceso, selezionare il dispositivo K-Plates e l'attività desiderata nella Homepage.

AVVISO

Quando il sensore è connesso, non metterlo in carica, non spostarlo, non appoggiarvi i piedi, non esercitare nessuna pressione sul dispositivo.

K-Bubble



Descrizione

K-Bubble è un sensore pneumatico che permette di lavorare sulla forza con appositi strumenti gonfiabili.

Vantaggi

K-Bubble è dotato di un sensore pneumatico (a pressione) e fornisce in tempo reale un biofeedback della pressione esercitata sul dispositivo gonfiabile usato.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Allenamento con accessori gonfiabili medici per la riabilitazione

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Bubble deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

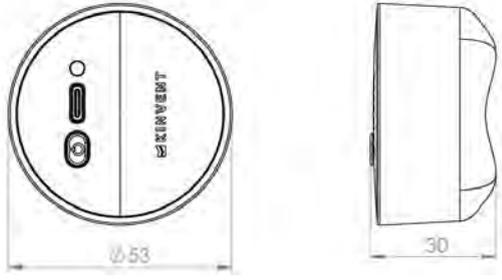
Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

K-Bubble è dotato di un sensore pneumatico (di pressione) che misura la pressione dell'aria dell'accessorio gonfiabile collegato.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	36 g / 1.27 oz
Dimensioni (LxH)	Metrico Ø53 x30 mm ; US Ø2.09 x 1.18 “ 
Pressione massima	0.4Bar / 5.8 PSI
Precisione	< 1.5%
Frequenza di acquisizione	125 Hz
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare KgF, N, lbs

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 160 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 50 metri / 56 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807 o X8WBM833
Batteria	12 ore in uso continuo, 1h30h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

- K-Bubble
- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica
- Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A
- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso
- Pacchetto accessori con 1x Body Roll, 1 Senso Ball 18cm, 1 x Air Grip, 1x valvola ad ago, 1 x tubo di collegamento

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Accessori

Il Pack K-Bubble contiene i seguenti accessori gonfiabili



Body Roll



Senso ball 18 cm



Air Grip

Avvio

Il sensore è dotato di una porta USB C, 1 LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e della ricarica e un tasto.

È possibile caricare il sensore K-Bubble con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB-C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medico IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica e, in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.

Premere il tasto arancione di avvio sul sensore K Bubble. Non appena l'indicatore comincia a lampeggiare con una luce verde, il sensore è in funzione! Dopo 10 minuti di mancata connessione con Bluetooth o con l'app, il dispositivo si spegnerà.

Inserire l'ago nella valvola del dispositivo utilizzato e selezionare nella Homepage il corrispondente strumento gonfiabile. Cominciare gli esercizi seguendo le istruzioni.

Importante

- **Inumidire l'ago prima di inserirlo nel dispositivo gonfiabile per evitare danni e per migliorare la tenuta.**
- **Prestare la massima attenzione quando si inserisce l'ago nell'apposita valvola dell'accessorio utilizzato.**
- **L'ago deve essere introdotto saldamente, senza toccare le parti interne dell'accessorio gonfiabile.**

AVVISO

Azzeramento della pressione

La comparabilità dei risultati dipende dalla pressione dell'accessorio gonfiabile. Dopo aver inserito l'ago nella valvola, svitarlo facendo circa mezzo giro, in modo da uniformare la pressione per circa 5 secondi. Quindi, riavvitare nuovamente l'ago. Assicurarsi che tutto sia ben saldo e che, esercitando una pressione sull'accessorio, non si sentano perdite d'aria, né si formino bolle d'aria sulla valvola. Sebbene il sensore funzioni in termini assoluti e non sia quindi influenzato da differenze tra la pressione interna e quella esterna, l'accessorio gonfiabile reagirà diversamente se troppo o poco gonfiato.

K-Move



Qualifica utente

K-Move deve essere utilizzato da professionisti del settore sanitario qualificati.

Descrizione

K-Move è un sensore inerziale in grado di misurare l'ampiezza della mobilità articolare e di comparare la simmetria tra l'ampiezza dell'arto da trattare e quella dell'arto sano.

Vantaggi

K-Move è dotato di un sensore IMU (unità di misura inerziale); fornisce in tempo reale un biofeedback dell'evoluzione tra il raggio di movimento dell'articolazione e la posizione iniziale.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Valutazione del raggio di movimento

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Move deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

K-Move è dotato di un sensore inerziale a 9 assi che misura l'angolo, l'accelerazione e la rotazione del dispositivo.

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

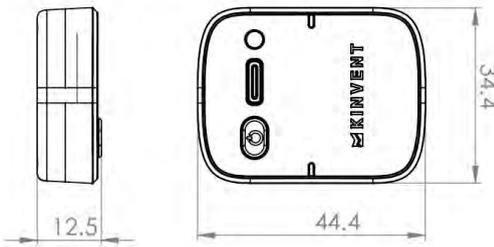
- K-Move
- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica
- Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A

- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso
- Pacchetto accessori con cinture

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	18 g / .063 oz
Dimensioni (LxH)	Metric 12.5 x 34.5 x 44.5 mm ; US : 0.49 x 1.36 x 1.75 " 
Accelerazioni massime	+/-16g
Precisione statica	2°
Precisione dinamica (testa, passo, rotazione)	7°, 2°, 2°
Frequenza di acquisizione	400 Hz
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare gradi

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 160 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 50 metri / 56 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807 o X8WBM833
Batteria	12 ore in uso continuo, 1h30h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Accessori :

K-Move è provvisto di accessori per un uso versatile

2 cinghie di lunghezza diversa:

- 57 cm per cosce / tricipeti
- 77 cm per busto / testa



Avvio

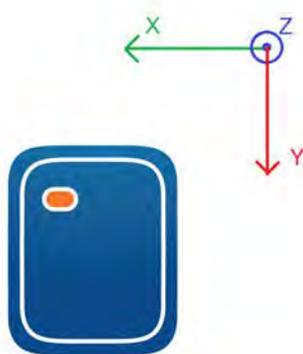
Il sensore è dotato di una porta USB C, 1 LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e della ricarica e un tasto.

È possibile caricare il sensore K-Move con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medico IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica e, in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.

Premere il tasto arancione di avvio sul sensore K-Move. Non appena l'indicatore comincia a lampeggiare con una luce verde, il sensore è in funzione! Dopo 10 minuti di mancata connessione con Bluetooth o con l'app, il dispositivo si spegnerà.

Dopo l'accensione del sensore, scegliere l'ampiezza dell'articolazione e il movimento da valutare. Applicare K-Move sull'arto del paziente, assicurandosi che il paziente rimanga in posizione neutra, al fine di inizializzare la posizione di riferimento. Il paziente può iniziare a muoversi dopo aver cliccato su AVVIO. Il raggio di movimento è misurato in gradi. Assicurarsi che il paziente non faccia movimenti di compensazione.

Qualora nella lista proposta non fosse disponibile l'ampiezza di un movimento ricercato, è possibile creare una valutazione personalizzata.



Definizione degli assi sul dispositivo

AVVISO

Per una maggiore precisione della misurazione del raggio di movimento, è raccomandato impostare la posizione iniziale sull'angolo corrispondente al grado zero, premendo l'avvio in quel punto. Fare attenzione ad evitare la compensazione con l'altro arto.



K-Pull

Qualifica utente

The K-Pull deve essere usato da professionisti del settore sanitario qualificati.

Descrizione

K-Pull è un dinamometro di trazione che permette la misurazione della forza isometrica e un allenamento con biofeedback.

Il dispositivo consente di effettuare misurazioni in maniera autonoma. Può essere agganciato su un tavolo fisioterapico, a una spalliera fissata a parete o a sistemi di pulegge.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Regolazione della distribuzione del peso/forza applicata a un arto inferiore o superiore.

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Pull deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

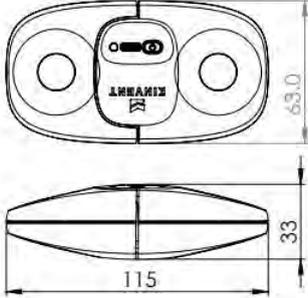
Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

K-Pull è dotato di 1 trasduttore di forza elettronico di estensione che converte la forza applicata in segnale elettrico che viene poi convertito in un'uscita digitale calibrata.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	150 g / 5.29 oz
Dimensioni (H x L x P)	Metric: 115 x 63 x 33 mm ; US : 4.53 x 2.48 x 1.3 " 
Forza massima	300 Kg / 661 lbs
Precisione	< 0.1% , C3 Class
Frequenza di acquisizione	1000 Hz
Diametro anello di collegamento	14 mm
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare KgF, N, lbs

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 280 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 40 metri / 44 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807
Batteria	12 ore in uso continuo, 2h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

- K-Pull
- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica
- Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A
- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso
- Pacchetto accessori con 2 moschettoni, 2 accessori di fissaggio, 2 elastici di resistenza, 1 cinghia rigida

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Accessori :

K Pull è fornito con accessori che ne permettono un uso versatile:

- 2 moschettoni (max 600kg)
- 2 accessori di fissaggio ad anello che permettono l'aggancio ad un tavolo fisioterapico, a una spalliera e all'arto interessato, con una forza massima di 180kg
- 2 elastici di resistenza per esercizi.
 - Fascia blu per resistenza tra 0,5 e 4 kg (più leggera), indicata per spalle e tibie.
 - Fascia arancia per resistenza tra 1 e 8 kg (leggera), indicate per bicipeti e tricipeti.
- 1 cinghia rigida regolabile per la misurazione della forza isometrica massima, fino a un massimo di 600kg.



Avvio

Il sensore è dotato di una porta USB C, 1 LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e della ricarica e un tasto.

È possibile caricare il sensore K-Pull con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB-C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medico IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica e, in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.

Premere il tasto arancione di avvio sul sensore K Pull. Non appena l'indicatore comincia a lampeggiare con una luce verde, il sensore è in funzione! Dopo 10 minuti di mancata connessione con Bluetooth o con l'app, il dispositivo si spegnerà.

Dopo l'accensione del sensore, selezionare nella Homepage il sensore K-Pull. Selezionare la parte del corpo che si vuole misurare e l'esercizio voluto tra quelli presenti nella lista. Il LED blu indicherà che la connessione è avvenuta.

AVVISO

Quando il sensore è connesso, non metterlo in carica, non spostarlo, non appoggiarvi i piedi, non esercitare nessuna pressione sul dispositivo.

⚠ WARNING

È un sensore ad alta forza di trazione, è quindi necessario prestare la massima attenzione alla scelta del punto di fissaggio sul dispositivo stesso o sugli accessori ad esso destinati. La cinghia e i moschettoni sono concepiti per una forza massima di 600 kg, l'estensione degli elastici non deve eccedere 2,5 volte la loro lunghezza.

AVVISO

Per una maggiore precisione della misurazione delle forza isometrica, la posizione del fissaggio dovrebbe essere sempre uguale e perpendicolare alla direzione della forza esercitata.

K-Deltas



Descrizione

K-Deltas sono due piattaforme indipendenti di valutazione della forza concepite per la riabilitazione dell'equilibrio e la valutazione della simmetria e della forza muscolare degli arti inferiori.

Vantaggi

K-Deltas sono dotate di trasduttori di forza elettronici che forniscono biofeedback acustici e ottici in tempo reale su smartphone o tablet con l'app Kinvent Physio.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Regolazione della distribuzione del peso/forza applicata a un arto inferiore o superiore.

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Force Plates deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

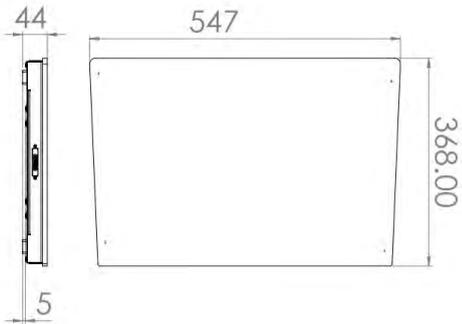
Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

I K-Delta sono dotati di 4 trasduttori elettronici di forza per piattaforma che convertono le forze applicate in segnali elettrici che vengono poi convertiti in uscite digitali calibrate.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	8.8 kg / 19.4 lbs per pedana
Dimensioni (H x L x P)	Metric 44 x 547 x368 mm US: 1.73 x 21.53 x 14.48 "
Altezza libera dal suolo di 5 mm/0,2".	
Forza massima	2000 kg per pedana(500 kg/sensore) 4410 libbre per pedana (1103 libbre/sensore)
Precisione	< 0.1%
Frequenza di acquisizione	1000 Hz / 2000 Hz Full CoP
Rivestimento	Foglio antiscivolo R11
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare KgF, N, lbs

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 800 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 20 metri / 22 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807 o X8WBM833
Batteria	20 ore in uso continuo, 2h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

- K-Deltas (2x plateformes)
- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica
- 2x Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A
- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Accessori

Le piattaforme K-Deltas possono essere usate con i seguenti accessori :

Deltas Frame è un accessorio studiato per le K-Deltas per permettere di stabilizzare le pedane e di ottenere una maggiore superficie, alla medesima altezza, consentendo di effettuare salti in tutta sicurezza. Inoltre, assicura la riproducibilità delle misurazioni in condizioni analoghe. Deltas Frame è realizzato in schiuma rigida. Può essere facilmente smontato per un trasporto e un deposito semplici; la sua leggerezza e facilità di spostamento garantiscono la sicurezza del paziente.

IMTP – Accessorio per la trazione isometrica della parte mediana della coscia. Accessorio di precisione, facilmente trasportabile e pratico per gli allenamenti. Comprende una pedana, una barra centrale e una barra per l'impugnatura. Può essere sistemato insieme alle piattaforme K-Deltas nella stessa custodia.

Installazione

Installare le K-Deltas secondo il programma di misurazione selezionato sulla schermata delle istruzioni.

Su pavimento

Ideale per gli esercizi di equilibrio. È possibile disporre le K-Deltas una a contatto dell'altra o distanziate. In tal modo si può far lavorare la forza muscolare di entrambi gli arti inferiori, aumentando il livello di difficoltà degli esercizi di equilibrio.



Avvio

Ogni piattaforma K-Deltas è munita di una porta USB C per la ricarica, 1 LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e della ricarica e un tasto.

È possibile caricare i sensori K-Deltas con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB-C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medico IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica e, in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.

 **AVVERTENZA** **Prima dell'uso disinfettare il dispositivo** con salviette disinfettanti a base di alcool.

Per avviare K-Deltas premere il pulsante di avvio di entrambe le pedane. Non appena il LED comincia a lampeggiare con il colore verde, K-Deltas è in funzione ! Il dispositivo si spegnerà dopo 10 minuti di inattività.

Quando il sensore è acceso, selezionare il dispositivo K-Deltas e l'attività desiderata nella Homepage.

 **AVVISO** **Quando il sensore è connesso, non metterlo in carica, non spostarlo, non appoggiarvi i piedi, non esercitare nessuna pressione sul dispositivo.**

K-Deltas XL



Qualifica utente

Le K-Deltas XL devono essere utilizzate da professionisti del settore sanitario qualificati.

Descrizione

K-Deltas XL sono due piattaforme indipendenti di valutazione della forza concepite per la riabilitazione dell'equilibrio

e la valutazione della simmetria e della forza muscolare degli arti inferiori.

Vantaggi

K-Deltas XL sono dotate di trasduttori di forza elettronici che forniscono biofeedback acustici e ottici in tempo reale su smartphone o tablet con l'app Kinvent Physio.

Dati sull'usabilità

Indicazione medica prevista:

Regolazione della distribuzione del peso/forza applicata a un arto inferiore o superiore.

Popolazione di pazienti prevista

Da adolescenti a geriatrici, con condizioni di salute normali o pre/post operazione solo su approvazione del medico per la riabilitazione.

Parte del corpo o tipo di tessuto destinato a o con cui ha interagito:

Sito: Aree esterne, tipicamente braccia, mani, busto, testa, gambe, piedi

Condizione: normale, senza ascessi né ferite.

Contatto diretto non richiesto, contatto su indumenti o tramite cuscinetti in silicone

Profilo utente previsto:

Il K-Force Plates deve essere utilizzato da un professionista sanitario qualificato. L'utente deve aver ricevuto una formazione sufficiente nelle procedure cliniche per ottenere misurazioni affidabili.

Ambiente d'uso previsto:

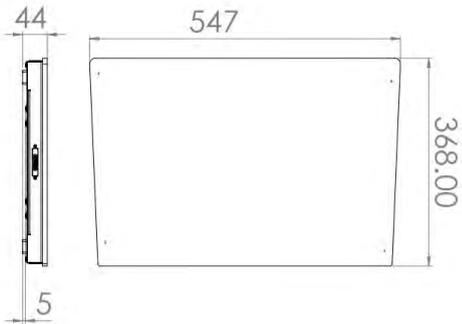
Ospedale o altro ambiente di pratica medica.

Principio operativo:

I K-Delta sono dotati di 4 trasduttori elettronici di forza per piattaforma che convertono le forze applicate in segnali elettrici che vengono poi convertiti in uscite digitali calibrate.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e Peso

Peso	8.8 kg / 19.4 lbs per pedana
Dimensioni (H x L x P)	Metric 44 x 547 x368 mm US: 1.73 x 21.53 x 14.48 "
Altezza libera dal suolo di 5 mm/0,2".	
Forza massima	2000 kg per pedana(500 kg/sensore) 4410 libbre per pedana (1103 libbre/sensore)
Precisione	< 0.1%
Frequenza di acquisizione	1000 Hz / 2000 Hz Full CoP
Rivestimento	Foglio antiscivolo R11
Ecologia	Modalità di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
Unità	È possibile selezionare KgF, N, lbs

Dati elettrici e di comunicazione

Tecnologia Radio	Bluetooth Low Energy 5.1
Alimentazione	Batteria LiPo 800 mAh, 1 cella 3,7V
Potenza irradiata in uscita	Max.10 mW
Frequenza trasmissione wireless	2.4 GHz band 2402- 2480 MHz
Modulazione	GFSK
Larghezza di banda del canale	2 MHz
ERP	8.6dbm
Portata wireless	Fino a 20 metri / 22 yd
Contiene l'ID FCC	2AAQS-ISP1807 o X8WBM833
Batteria	20 ore in uso continuo, 2h per la ricarica
Requisiti minimi	Android 6.0+ or iOS 11.0+, Bluetooth Low Energy

Contenuto del pacchetto commerciale

L'Utente riceverà:

- K-Deltas (2x plateformes)

- Adattatore di alimentazione di grado medico con USB-A per la ricarica
- 2x Cavo di ricarica/dati da USB-C a USB-A
- Schede di avvio rapido in EN/FR/ES
- Manuale d'uso

La batteria non è rimovibile, è già installata nel dispositivo

Installazione

Installare le K-Deltas secondo il programma di misurazione selezionato sulla schermata delle istruzioni.

Su pavimento

Ideale per gli esercizi di equilibrio. È possibile disporre le K-Deltas una a contatto dell'altra o distanziate. In tal modo si può far lavorare la forza muscolare di entrambi gli arti inferiori, aumentando il livello di difficoltà degli esercizi di equilibrio.



Avvio

Ogni piattaforma K-Deltas XL è munita di una porta USB C per la ricarica, 11 LED che permette di indicare lo stato dell'utilizzazione e della ricarica e un tasto.

È possibile caricare i sensori K-Deltas XL con il cavo USB A o il cavo USB C forniti, o tramite qualsiasi cavo USB-C. Il sensore viene fornito con l'adeguato alimentatore medico IEC 60601 USB. Se viene utilizzato un caricatore diverso da quelli indicati, assicurarsi che questo soddisfi i requisiti minimi di sicurezza medica e, in caso di dubbio, non usare il sensore quando è collegato al cavo o durante la ricarica.



AVVERTENZA

Prima dell'uso disinfettare il dispositivo con salviette disinfettanti a base di alcool.

Per avviare K-Deltas XL premere il pulsante di avvio di entrambe le pedane. Non appena il LED comincia a lampeggiare con il colore verde, K-Deltas XL è in funzione! Il dispositivo si spegnerà dopo 10 minuti di inattività.

Quando il sensore è acceso, selezionare il dispositivo K-Deltas XL e l'attività desiderata nella Homepage.

AVVISO

Quando il sensore è connesso, non metterlo in carica, non spostarlo, non appoggiarvi i piedi, non esercitare nessuna pressione sul dispositivo.

Risoluzione di problemi

Se si riscontrano difficoltà durante l'uso del sistema, verificare la seguente lista e seguire i suggerimenti indicati. Per ulteriore assistenza, si prega di rendersi sul sito di KINVENT Help Center [Kinvent.link/quickstart](https://kinvent.link/quickstart) o nel menu "Supporto" dell'app Kinvent Physio.

Problemi con il sensore

Problema	Soluzione
Il dispositivo non si avvia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare un caricabatterie funzionante con un cavo USB funzionante e caricare il sensore per almeno 30 minuti. Collegare e poi scollegare il cavo USB: dopo poco, dovrebbe accendersi una luce arancione o verde. 2. Premere il tasto On/Off fino a quando si sente lo scatto in modo chiaro e percettibile. 3. Se si sospetta un guasto, è possibile contattare il fornitore o consultare il nostro sito internet per verificare il programma di sostituzione, o anche contattare direttamente il nostro servizio nel menu di Assistenza K PHYSIO.
Anche dopo aver disattivato l'app, il LED blu del sensore rimane acceso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che l'applicazione sia disattivata. Su Android mantenere premuto il tasto "Home" o premere il tasto "Applicazioni usate recentemente" per visualizzare le applicazioni in esecuzione. Per disattivare l'applicazione, far scorrere il tasto verso sinistra o verso destra. 2. Disattivare il Bluetooth sul tablet o lo smartphone usati. 3. Tenere premuto il tasto on/off per 5 secondi per forzare lo spegnimento.
Il sensore non si spegne dopo 10 minuti di inattività	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se è attiva una connessione (indicata da una luce blu) e disattivare l'applicazione e il Bluetooth. Eventualmente, forzare lo spegnimento del sensore tenendo premuto il tasto on/off per 5 secondi. 2. Verificare che il dispositivo non sia in carica. 3. Se il problema sussiste, è possibile seguire le istruzioni presenti nell'applicazione per la reinizializzazione di base.
Messaggio di errore di calibrazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere l'app e ricominciare, assicurandosi che il sensore non sia in carica. Con i sensori K-Plates e K-Deltas, verificare che la superficie di appoggio sia piana, che i piedi aderiscano alle pedane e che le pedane siano ben stabili. Con il sensore K-Move

non spostare e non urtare il dispositivo durante l'operazione di calibrazione.

2. Per programmare una calibrazione, contattare KINVENT. Si raccomanda di
3. effettuare la calibrazione del prodotto una volta all'anno o più spesso se si applicano condizioni particolari.

Parte danneggiata o persa

1. Contattare KINVENT per concordare la sostituzione di una parte.

Difficoltà di connessione

Problema	Soluzioni
<p>Il dispositivo è acceso, ma non si connette.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che lo smartphone o il tablet siano compatibili con K Physio. 2. Verificare che il Bluetooth e la localizzazione siano abilitati sul tablet o lo smartphone. 3. Verificare che i dispositivi siano correttamente caricati – Premendo il tasto, si accende l'indicatore LED e premendo una seconda volta si accende una luce fissa che indica il livello della batteria. Accertarsi che questa luce sia verde o arancione. 4. Riavviare l'applicazione. Su Android mantenere premuto il tasto "Home" o premere il tasto "Applicazioni usate recentemente" per visualizzare le applicazioni in esecuzione. Per disattivare l'applicazione, far scorrere il tasto verso sinistra o verso destra 5. Riavviare il tablet o lo smartphone. 6. Assicurarsi che il dispositivo sia vicino al tablet o allo smartphone, idealmente a non più di 5 metri. 7. Nelle impostazioni Bluetooth del tablet, non effettuare l'abbinamento dei dispositivi K-sensor manualmente; se è stato fatto, disattivare immediatamente l'abbinamento.
<p>Il dispositivo si disconnette durante l'uso</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durante l'uso non collegare l'USB C del sensore a un computer o a smartphone per la ricarica. Usare esclusivamente il caricatore USB in dotazione o uno equivalente
<p>Durante la connessione, l'app indica un cerchio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne il dispositivo e riaccendere. 2. Verificare di trovarsi nel raggio d'azione del sensore. 3. Le specifiche ufficiali di Bluetooth fissano a sette il numero massimo di dispositivi che possono essere connessi

grigio o rosso sul sensore.

contemporaneamente. Tuttavia, **tre o quattro dispositivi** è il limite reale, a seconda del tipo di sensore. Verificare che nessun altro dispositivo (cuffie, altoparlanti, ecc) sia connesso in Bluetooth.

Dopo la connessione, il led verde continua a lampeggiare.

1. È possibile che ci sia un altro sensore nelle vicinanze. Identificare il sensore interessato, grazie al numero di serie che si trova nel menù di registrazione del dispositivo dell'applicazione.
2. Verificare se altri sensori siano nelle vicinanze e distattivarli; è possibile effettuare questa operazione anche manualmente.
3. Per i dispositivi K-Plates e K- Deltas verificare che siano accese entrambe le pedane.

Informazioni legali

Condizioni di garanzia

La presente garanzia non è valida se il dispositivo:

- è utilizzato con prodotti non compatibili
- è utilizzato a fini commerciali, quali il noleggio
- è modificato
- è danneggiato da incidenti, uso improprio, usura o qualsiasi altra causa non imputabile a difetti dei materiali o della sua fabbricazione.

Per ottenere i servizi di garanzia, è necessario esibire una prova valida di acquisto del prodotto, quale fattura o ricevuta d'acquisto.

KINVENT esclude qualsiasi responsabilità per la Perdita di dati, di profitto o. per qualsiasi altra perdita o danno subito dal cliente.

Unione europea

Le componenti elettroniche e tutte le parti meccaniche dei dispositivi K-Sensors sono garantite per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, a condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità al presente manuale. KINVENT può procedere alla sostituzione gratuita di un dispositivo K-Sensors coperto da garanzia. La garanzia non viene applicata in caso di modifica o sostituzione di componenti del dispositivo K-Sensors effettuata senza la previa autorizzazione di KINVENT o del rivenditore KINVENT autorizzato. KINVENT non garantisce alcun risultato terapeutico con l'uso dei dispositivi K-Sensors. Contattare KINVENT o il distributore autorizzato per ricevere l'autorizzazione alla restituzione e per le istruzioni di spedizione.

Altri Paesi

Le componenti elettroniche e tutte le parti meccaniche dei dispositivi K-Sensors sono garantite per un periodo di 1 anno dalla data di acquisto, a condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità al presente manuale. KINVENT può procedere alla sostituzione gratuita di un dispositivo K-Sensors coperto da garanzia. La garanzia non viene applicata in caso di modifica o sostituzione di componenti del dispositivo K-Sensors effettuata senza la previa autorizzazione di KINVENT o del rivenditore KINVENT autorizzato. KINVENT non garantisce alcun risultato terapeutico con l'uso dei dispositivi K-Sensors. KINVENT o il distributore autorizzato per ricevere l'autorizzazione alla restituzione e per le istruzioni di spedizione.

Obblighi dell'Utente

Salvo in caso di danno o difetto attribuibile a KINVENT Biomecanique, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di KINVENT o delle sue filiali per eventuali prodotti o componenti danneggiati o difettosi. L'utente deve esaminare attentamente lo stato dei prodotti immediatamente dopo il ricevimento.

Se le istruzioni fornite da KINVENT Biomecanique in merito allo stoccaggio, all'installazione e alla manipolazione dei prodotti non vengono rispettate o se vengono apportate modifiche al prodotto, se i componenti vengono sostituiti o se vengono utilizzati articoli di consumo non conformi alle specifiche originali, qualsiasi garanzia i diritti si perdono a meno che l'utente non sia in grado di confutare qualsiasi affermazione secondo cui solo una qualsiasi di queste circostanze ha causato il difetto.

Difetti, consegne errate, quantità o danni di trasporto devono essere notificati senza indugio dall'utente per iscritto, via fax o via e-mail (in caso di difetti immediatamente identificabili) ai distributori di KINVENT Biomecanique o direttamente a KINVENT Biomecanique, altrimenti entro due settimane dal ricevimento dei prodotti nel luogo di destinazione, descrivendo chiaramente il difetto; a tale riguardo, è necessario che l'utente adempia correttamente ai propri obblighi di indagine e notifica.

Nel caso in cui sia necessario restituire uno o più K-SENSOR, i sensori e gli accessori devono essere decontaminati e privi di materiale infetto per poter essere maneggiati in sicurezza in un laboratorio di sicurezza non biologica (vedere le istruzioni per la pulizia su ciascun sensore).

I K Sensors devono essere restituiti nella confezione originale. Se non è più disponibile, si prega di informare l'assistenza o il distributore autorizzato.

Come imballare un prodotto da restituire

- Avvolgere il dispositivo in pluriball
- Stampare e compilare il modulo di assistenza clienti
- Impacchettare insieme il dispositivo e il modulo compilato
- Applicare il buono di restituzione sull'imballaggio e spedire

Sono considerate degradazioni del materiale i seguenti elementi:

- Graffi
- Parti rotte a causa di cadute accidentali o usi inappropriati
- Modifica o sostituzione di qualsiasi componente
- Esposizione in ambiente umido
- Immersione in acqua
- Esposizione a temperature estreme

Assistenza

L'utente riconosce che ogni operazione eseguita sui prodotti K-Sensors può modificare le impostazioni o causare la perdita di dati o di alcune funzionalità. Si raccomanda di eseguire regolarmente il backup dei dati memorizzati sul tablet o sullo smartphone.

 **AVVERTENZA**

K-Sensors è un dispositivo medico. K-Sensors deve essere usato conformemente al presente Manuale d'uso e delle raccomandazioni ivi contenute. L'inosservanza di tali precauzioni può causare danni alle persone.

Gli utenti sono responsabili delle scelte degli esercizi e del modo in cui vengono utilizzati i dispositivi K-Sensors. Vi sono possibili rischi di lesioni conseguenti ai movimenti effettuati con dispositivi K-Sensors.

Consultare regolarmente il sito web di KINVENT per ottenere informazioni disponibili su controindicazioni e rischio di eventuali effetti collaterali dell'uso dei K-Sensors. Kinvent non propone consulenze terapeutiche, né diagnosi mediche.

Nel caso di pazienti in cura, che presentino lesioni o che siano in condizioni cliniche precarie, si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di usare qualsiasi prodotto K-Sensors.

KINVENT non garantisce alcun risultato terapeutico con l'uso dei prodotti K-Sensors.

Politica sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questa sezione fornisce informazioni sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti nell'Unione Europea.

La Direttiva Europea 2012/19/CE sui RAEE richiede il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del loro ciclo di vita. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato (vedi sotto) indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti; deve essere portato in un impianto di trattamento autorizzato o in un punto di raccolta designato per il riciclaggio, secondo la legislazione locale. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e garantisce che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente



KINVENT accetta la propria responsabilità in conformità con i requisiti specifici di riciclaggio RAEE e, laddove un prodotto sostitutivo venga fornito da KINVENT, fornisce il riciclaggio gratuito delle proprie apparecchiature elettroniche contrassegnate RAEE in Europa. Se un prodotto sostitutivo non viene acquistato da KINVENT, il riciclaggio può essere fornito su richiesta a un costo aggiuntivo. Per riciclare apparecchiature elettroniche, contattare il distributore locale per il modulo di restituzione richiesto. Una volta inviato il modulo, verrai contattato dal distributore per richiedere informazioni di follow-up per programmare la raccolta dei rifiuti elettronici o per fornirti un preventivo individuale.

Dichiarazione di conformità

I sensori KINVENT sono:

Dispositivi medici di misura di Classe I, conformemente all'Allegato IX della Direttiva del Consiglio 93/42/EEC.

K-Plates, K-Deltas sono :

Dispositivi medici di Classe I, conformemente al CFR americano (Codice Regolamenti Federali) Titolo 21 Parte 890, Capitolo B, Sezione 890.1575

K-Push, K-Pull, K-Grip, K-Bubble sono :

Dispositivi medici di Classe II, conformemente al CFR americano (Codice Regolamenti Federali) Titolo 21 Parte 890, Capitolo B, Sezione 890.1925

K-Sens è :

Dispositivi medici di Classe I, conformemente al CFR americano (Codice Regolamenti Federali) Titolo 21 Parte 890, Capitolo B, Sezione 888.1500

I sensori KINVENT Sensors sono:

Dispositivi medici di Classe II, conformemente alla Norma 10 del Regolamento canadese sui dispositivi medici.

Si dichiara la conformità dei dispositivi KINVENT Sensors ai seguenti standard tecnici :

I Sensori KINVENT soddisfano inoltre le seguenti Norme Tecniche, alle quali viene dichiarata la Conformità:

IEC 60601-1:2005, +AMD1:2012 +AMD2:2020	Apparecchiature elettromedicali - parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali
IEC 60601-1-11:2015 + AMD1:2020	Apparecchiature elettromedicali - parte 1-11: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali. Standard collaterale: requisiti per apparecchiature elettromedicali e sistemi elettromedicali utilizzati nell'ambiente sanitario domestico
60601-1-2:2014+A1:2020	Apparecchiature elettromedicali - parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali. Norma collaterale: disturbi elettromagnetici. requisiti e test
CISPR 11:2015+A1:2016+A2:2019	Emissioni irradiate Gruppo 1, classe B
CEI 61000-3-2: 2019+A1:2021,	Emissioni di correnti armoniche
EN 61000-3-3:2013+A2:2021,	Fluttuazioni di tensione e flicker
CEI 61000-4-2:2008	Immunità ESD, contatto $\pm 8\text{kV}$, aria ± 2 , ± 4 , ± 8 , $\pm 15\text{kV}$
CEI 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2 010,	Immunità ai campi irradiati 80 MHz - 2,7 GHz, 10 V/m
CEI 61000-4-4:2012,	Immunità EFT/B
CEI 61000-4-5:2014+A1:2017	Immunità alle sovratensioni
CEI 61000-4-6:2013,	Immunità RF condotta
CEI 61000-4-8:2009,	Immunità ai campi magnetici a frequenza di rete: 30A/m

	50 e 60 Hz
CEI 61000-4-11:2004+A1:2017	Cali di tensione

I sensori KINVENT sono progettati e prodotti in uno stabilimento certificato secondo i seguenti standard internazionali:
NELLA ISO 9001:2015

I prodotti KINVENT sono soggetti agli standard di qualità all'interno del sistema di gestione della qualità secondo ISO 13485::2016

Guida e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche		
I K-SENSORS sono destinati all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utente dei K-SENSORS deve assicurarsi che vengano utilizzati in tale ambiente.		
Prova delle emissioni	Conformità	Guida all'ambiente elettromagnetico
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 2	I dispositivi K SENSORS utilizzano energia RF solo per il proprio funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse ed è improbabile che causino interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine.

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica			
I K-SENSORS sono destinati all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utente dei K-SENSORS deve assicurarsi che vengano utilizzati in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Guida all'ambiente elettromagnetico
Elettrostatico scarica (ESD) CEI-61000-4-2	Contatto ± 8 kV 2, 4, 8, 15kV in aria	Contatto ± 8 kV 2, 4, 8, 15kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Frequenza di alimentazione (50/60 Hz) campo magnetico	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici a frequenza di rete devono essere ai livelli caratteristici di una posizione tipica in un ambiente domestico.

IEC 61000-4-8			
NOTA UT è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di test			

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica			
I K-SENSORS sono destinati all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utente dei K-SENSORS deve assicurarsi che vengano utilizzati in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Guida all'ambiente elettromagnetico
RF irradiata CEI 61000-4-3	3V/m da 0,15 a 80 MHz 6V/m da 0,15 a 80 MHz e 80% AM a 1 kHz 10V/m da Da 80 MHz a 2,7 GHz	3V/m da 0,15 a 80 MHz 6V/m da 0,15 a 80 MHz e 80% AM a 1 kHz 10V/m da Da 80 MHz a 2,7 GHz	<p>Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili non devono essere utilizzate più vicino a nessuna parte dei SENSORI K, compresi i cavi, rispetto alla distanza di separazione consigliata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.</p> <p>Distanza di separazione consigliata</p> $d = \frac{3.5}{IN_1} \sqrt{P}$ $d = \frac{12}{IN_2} \sqrt{P}$ $d = \frac{12}{E_1} \sqrt{P} \text{ Da } 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = \frac{23}{E_1} \sqrt{P} \text{ Da } 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ <p>Dove P è la massima potenza nominale in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e D è la separazione consigliata distanza in metri (m).</p> <p>Intensità di campo da trasmettitori RF fissi, come determinato da un'indagine elettromagnetica del sito^A, dovrebbe essere inferiore al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenza^B.</p> <p>Possono verificarsi interferenze in</p>

			prossimità di apparecchiature contrassegnate dal seguente simbolo: 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza superiore. NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata per assorbimento e riflessione da strutture, oggetti e persone.			
<p>^ALe intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in considerazione un'indagine elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui vengono utilizzati i K SENSORI supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, è necessario osservare i K SENSORI per verificarne il normale funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive, come il riorientamento o il riposizionamento dei SENSORI K.</p> <p>^B Nell'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo dovrebbero essere inferiori a V_1 V/m.</p>			

Distanze di separazione consigliate (in m) tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e i SENSORI K

I K SENSORI sono destinati all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente dei K SENSORS può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e i K SENSORS come raccomandato di seguito, in base alla potenza di uscita massima delle apparecchiature di comunicazione.

Potenza massima nominale potenza del trasmettitore Watt	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore			
	Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM	Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM $d = \frac{12}{IN_2} \sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz $d = \frac{12}{E_1} \sqrt{P}$	Da 800 MHz a 2,5 GHz $d = \frac{23}{E_1} \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.2	0.4	1
0.1	0,37	0,64	1.3	2.6
1	1.17	2	4	8
10	3.7	6.4	13	26
100	11.7	20	40	80

Per i trasmettitori con potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del

trasmettitore, dove P è la massima potenza nominale in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza superiore.

NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

Specifiche dei test per l'IMMUNITÀ DELLA PORTA DELL'INVOLUCRO alle apparecchiature di comunicazione wireless RF							
Frequenza di prova (MHz)	Gruppo musicale (MHz)	Servizio	Modulazione	Potenza massima (W)	Distanza (m)	Livello di test di immunità (V/min)	Livello di conformità (V/m)
385	380-390		Modulazione di impulsi 18 Hz	1.8	0.3	27	27
450	430-470		Deviazione FM +/-5 KHz	2	0.3	28	28
710	704-787	Banda LTE 13, 17	Modulazione di impulsi 217 Hz	0.2	0.3	9	9
745							
780							
810	800-960	Banda LTE 5	Modulazione di impulsi 18 Hz	2	0.3	28	28
870							
930							
1720	1700-1990	Banda LTE 1, 3, 4, 25	Modulazione di impulsi 217 Hz	2	0.3	28	28
1845							
1970							
2450	2400 - 2570	Bluetooth, Wi-Fi, 802.11 b/g/n RFID 2450 Banda LTE 7	Modulazione di impulsi 217 Hz	2	0.3	28	28
5240	5100 - 5800	Wi-Fi 802.11 a/n	Modulazione di impulsi	0.2	0.3	9	9
5500							
5785							

Informazioni FCC (Commissione Federale per le Comunicazioni degli USA)

K-Sensors è un prodotto che impiega radiofrequenze durante il suo funzionamento.

Tutti i dispositivi K-Sensors sono stati testati e sono risultati conformi ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi del capitolo 15 della normativa FCC. Tali limiti sono definiti in modo da fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un ambiente destinato all'abitazione. I dispositivi in oggetto generano, usano e possono irradiare energia in radiofrequenza; se non installati e utilizzati conformemente alle istruzioni, possono causare interferenze che disturbano le comunicazioni radio. Non è possibile garantire che tali interferenze non avvengano in particolari situazioni. In caso di interferenze con la ricezione radiotelevisiva, provocate per esempio con l'accensione o lo spegnimento dei dispositivi, si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

- Orientare diversamente o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare i dispositivi a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore
- Rivolgersi al fornitore o a un tecnico specializzato in radio/TV per assistenza.

Canada

Il dispositivo presenta un emittente/ricevente esente da licenza, conformemente alla normativa sulle specifiche standard della Commissione per l'Innovazione, la Scienza e lo Sviluppo economico canadese applicabile ai dispositivi radio esenti da licenza. L'uso è consentito nel rispetto delle due seguenti condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze.
2. Il dispositivo deve poter resistere a qualsiasi interferenza radioelettronica, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente trasmettitore radio è stato approvato dalla Commissione per l'Innovazione, la Scienza e lo Sviluppo economico canadese per operare con i tipi di antenna di seguito indicati, entro e non oltre l'aumento di guadagno massimo indicato.

I tipi di antenna non presenti nella lista, che abbiano un guadagno superiore a quello massimo indicato per ogni tipo di trasmettitore elencato, sono strettamente proibiti per l'uso dei presenti sensori.

Japan

Ai sensi della legge sulla Radiofrequenza del Giappone, il modulo Bluetooth ha ricevuto la certificazione e il label di conformità tecnica, nonché il numero di certificazione, per rispondere alla conformità agli standard tecnici regolamentati dal Ministero dell'Interno e della Comunicazione (MIC) giapponese

Numero certificazione 020-200037, 201-190838/00

Svizzera :

Per il mercato svizzero, la nostra gamma di prodotti è registrata presso swissmedic e il nostro rappresentante autorizzato per la Svizzera (CH-REP) è Freyr Life Sciences GmbH.

**Regno Unito:**

Per il mercato del Regno Unito, la nostra gamma di prodotti è registrata presso l'MHRA e il nostro rappresentante autorizzato per il Regno Unito (UKRP) è I3CGLOBAL(UK) (Office 54, No.58 Peregrine Road, Hainault, IG63SZ, England).

Contatti

Per maggiori informazioni o per l'Assistenza contattare:

www.k-invent.com

support@k-invent.com

Rond-Point Benjamin Franklin

34000 Montpellier, FRANCIA

Rilascia modifiche

E2023A_IT	2022-09-07	Versione iniziale
E2023B_IT	2022-11-29	Aggiunti schemi con dimensioni per tutti i dispositivi, foto aggiornate degli esercizi K Plates.
E2023C_IT	2022-12-19	Aggiunto K Deltas XL
E2023D_IT	2023-02-23	Immagini aggiornate degli accessori K Bubble.
E2023E_IT	2023-06-01	Tabella nome commerciale e nome medico, tabella modifiche, versione K Physio e tabella funzionale. Aggiunta IEC 60601-1-11, aggiunta di ID FCC, specifiche di altitudine.
E2023F_IT	2023-07-28	Icone di avvertenza e avviso, icona BLE, sezione Pulizia, Dichiarazioni di immunità ed emissioni, Obblighi dell'utente



KINVENT

MEASURE. MOVE. PROGRESS